

دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب

نشریه شماره ۲۶۵

وزارت نیرو
سازمان مدیریت منابع آب
دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
<http://www.mpor.org.ir>

جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب

نشریه شماره ۲۶۵

وزارت نیرو

سازمان مدیریت منابع آب ایران

دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

معاونت امور فنی

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

۱۳۸۲

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۲/۰۰/۲۷

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب / معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
؛ وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب. - تهران:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات،
۱۳۸۲.

۱۵ ص. مصوّر. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و
معیارهای فنی؛ نشریه شماره ۲۶۵) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور؛ ۲۷؛ ۰۰/۸۲)

ISBN 964-425-425-2

مرربوط به بخش‌نامه شماره ۱۰۱/۲۵۹۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰

۱. آب - آزمایشگاهها - دستنامه‌ها. ۲. آب - آزمایشگاهها - ابزار و وسایل. ۳. آب -
تجزیه و آزمایش. الف. سازمان مدیریت منابع آب ایران. ب. سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

TA ۳۶۸/۲۴ ۲۶۵ ش.س ۱۳۸۲

ISBN 964-425-425-2

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۲

دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
تهییه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور پشتیبانی. مرکز مدارک علمی و انتشارات
چاپ اول: ۱۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۲
قیمت: ۳۰۰۰ ریال
لیتوگرافی: قاسملو
چاپ و صحافی: چاپ زحل
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

بسمه تعالیٰ



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره:	۱۰۱/۲۵۹۲۲	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۸۲/۲/۲۰	
موضوع: برپایی آزمایشگاه آب		
<p>به استناد آین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت، ۱۴۸۹۸) مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران (به پیوست، نشریه شماره ۲۶۵ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده نمایند و در صورتی که روشها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.</p> <p>شایان ذکر است که عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمای جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، ارسال دارند.</p>		
<p>من ا... توفيق محمد ستاری فرد معاون ریس جمهور و ریس سازمان</p>		

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصطفی مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است. با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دستاندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی

ترکیب اعضای کمیته

ترکیب اعضای کمیته فنی شماره ۱۲ گروه کیفیت که در تهیه و تدوین این پیش‌نویس استاندارد مشارکت داشته‌اند به ترتیب حروف الفباء به شرح زیر هستند:

خانم زهرا ایزدپناه	فوق‌لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی
آقای رحمتعلی براتعلی	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی
آقای ماشاءالله تابع جماعت	لیسانس مهندسی عمران - آب
آقای علی‌اکبر علوی	فوق‌لیسانس شیمی و مهندسی بهداشت
خانم فاطمه فروغی‌زاده	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی
آقای شهرام کریمی	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی
آقای بیژن مهرسا	فوق‌لیسانس مهندسی آبهای زیرزمینی
آقای مهدی هاشمی	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۲	برپایی آزمایشگاه آب -
۲	طراحی آزمایشگاه -۱
۴	عوامل ایمنی در طراحی -۲
۴	آزمایشگاه سیار -۳
۷	انتخاب دستگاههای آزمایشگاهی -۴
۷	انتخاب مواد شیمیایی -۵
۸	ظروف آزمایشگاهی -۶
۸	نمونه برداری -۷
۹	برنامه آزمایش -۸
۹	تهیه لوازم -۹
۱۰	آزمایش آب -۱۰
۱۲	عناصر نادر -۱۱
۱۵	فهرست منابع و مأخذ

مقدمه

مطالعه و ارزیابی کیفی آب، بخش مهمی از بررسیهای منابع آب را شامل می‌شود. با تحلیل داده‌های غلظتی عناصر و مواد آلاینده موجود در آب، می‌توان آن را از نظر کاربری در مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، گروه‌بندی نموده، وارسیهای لازم را اعمال کرد. بنابراین کیفیت شیمیابی آب که خود مبنی بر اندازه‌گیری پارامترهای کیفی است، از ابزارهای مهم مطالعاتی آب به شمار می‌رود.

ارزشیابی طبیعی و کاربردی آب، براساس کیفیت آن ارزیابی می‌شود. ویژگیهای فیزیکی، شیمیابی و زیست‌شناسخی، کیفیت طبیعی آب را تشکیل داده و با روشهای استاندارد، آزمونهای فیزیکی، شیمیابی و زیست‌شناسی، سنجش و برآورد می‌شوند. آزمایش آب نیاز به ابزار، دستگاه و وسائل شیشهای دارد. آزمایشگاه آب، مکانی است که تجهیزات و مواد مصرفی به طوری آرایه داده شوند که عملیات ذیربطری به آسانی انجام گیرد. برای تعیین مواد موجود آب در صحرا می‌توان از آزمایشگاههای سیار استفاده کرد. در پایش کیفی آب، آزمایشگرهای خودکار، در محلهای کارشناسی شده، نصب و نتایج به دست آمده از مرکز وارسی می‌شود.

در این دستورالعمل، طرح ساخت، تأسیس، دایرکردن و برپایی آزمایشگاه آب ارائه شده و در آن، تأسیسات آب، برق، گازها، تهویه مطبوع، وسائل هشداردهنده آتش‌نشانی، آرایه میزهای آزمایشگاهی، انبار، اتفاقهای کارکنان، مخابرات و کتابخانه پیش‌بینی شده است.

برپایی آزمایشگاه آب

فرآیند مبانی تعیین مواد محلول در آب، پیش نیازی برای شناخت کیفی منابع آب و مسایل مهم مهندسی آب است، که در آزمایشگاهها به کمک تجزیه کیفی و کمی عناصر موجود در آب تعیین می‌گردد.

در پروژه‌های آبی برای طراحی مهندسی و بهینه‌سازی، گام نخست، شناسایی خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی آب است و این مهم با تجزیه کامل آب در آزمایشگاه تحقق می‌باید. بنابراین برپایی آزمایشگاه، نمونه‌برداری آب و انتقال نمونه‌ها، از کارهای اساسی مرحله شناسایی بوده و پایه مطالعات کیفی آب را تشکیل می‌دهد.


برپایی آزمایشگاه آب بستگی به اهداف و دامنه فعالیتهای علمی پروژه‌های آبی سوردنظر دارد که نیازمند به سرمایه‌گذاری، تأمین اعتبارات کافی، نیروی انسانی و همچنین دسترسی به دستگاه‌های آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مورد مصرف می‌باشد. هنگامی که هدف کاملاً مشخص شود، نسبت به مراحل اجرای کار و برآورده زینه‌ها تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

۱- طراحی آزمایشگاه

برای طراحی آزمایشگاه تجزیه آب، باید از حداقل فضای محیط استفاده شده و سعی گردد که میزهای آزمایش، تمام فضای اتاق را اشغال ننماید. در گذشته میزهای کار را در کنار دیوارهای اتاق قرار می‌دادند و چنانچه فضای خالی در وسط باقی می‌ماند یک میز نیز در وسط گذاشته می‌شد، این ترتیب، مناسب کار در آزمایشگاه نبوده و گوشش‌های اتاق خالی می‌ماند. از طرفی سرویسهای آب، گاز، برق در دسترس نبوده و همواره با اشکالاتی مواجه می‌گردید. امروزه برای برپایی یک آزمایشگاه مناسب، سعی می‌شود که لوله‌های آب و گاز در وسط آزمایشگاه قرار گیرد، در این صورت شیرهای مربوطه به آسانی در دسترس قرار گرفته و کارکنان با مشکل مواجه نمی‌شوند.

به دلیل وجود گازها و بخارات سمی در محیط آزمایشگاه، نیاز است که سیستم تهویه مناسب بوده و ارتفاع سقف بر حسب موقعیت مکانی، بلند در نظر گرفته شود.

در شکل ۱ طرح یک نمونه آزمایشگاه کوچک، نشان داده شده که از دو قسمت یا مدول^۱ به ابعاد 5×3 متر، تشکیل شده است. جای کافی و مناسب برای حدائق دو نفر پیش‌بینی گردیده که هر یک در وسعت ۱۵ متر مربع به راحتی می‌توانند کار کنند.

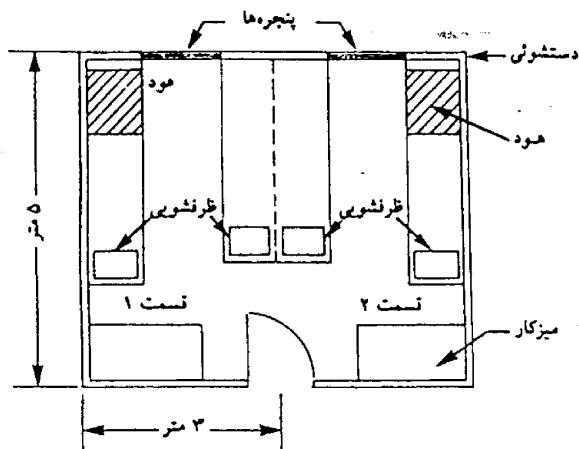

شکل ۱- طرح یک نمونه آزمایشگاه کوچک دو قسمتی

و سعیت آزمایشگاه بستگی به دامنه کار پروژه مورد مطالعه، تعداد نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه، امکانات تجهیزاتی و بالاخره اعتبار مالی دارد. برای مثال کمیته اعطای کمکهای بلاعوض دانشگاهی انگلیس^۱ ابعاد و فضای آزمایشگاه را به شرح زیر توصیه نموده است.

- محل کافی برای رئیس آزمایشگاه، ۱۸/۶ مترمربع. (۲۰۰ فوت مربع)
- محل کافی برای تکنیسین، ۱۱ مترمربع که شامل میزکار، هود و سایر فضاهای لازم است.
- محل کافی برای استقرار میز ترازو و انبار، ۱۵ درصد از کل مساحت آزمایشگاه.
- محل کافی برای انبارداری و کارهای پیش آزمایشی، مساحتی حدود ۷۰ مترمربع. (۷۵ فوت مربع)
- محل کافی جهت نگهداری هر ۱۰۰۰ جلد کتاب در مساحت ۵/۶ مترمربع. (۶۰ فوت مربع)
- فضای مناسب برای قراردادن نمونه‌های آب، قبل و بعد از آزمایش.
- مصالح به کار برده شده، برای کف پوشها و روی میزکار، باید از جنس مرغوب انتخاب شده، اسید و قلیا، آنها را از بین نبرد و کاملاً قابل شست و شو و مسطح باشد.
- محل استقرار اتوکلاو در نزدیک محیط کشت، خواهد بود و برای شست و شوی لوازم و وسایل استریل شده تجهیزات لازم باید در نظر گرفته شود.
- سردخانه و یخچال برای نگهداری محیطهای کشت و مواد شیمیایی آزمایشگاه ضروری است.
- قفسه‌های لازم برای نگهداری مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی در نظر گرفته شود.
- در ناحیه میز ترازو هیچ‌گونه ارتعاش و لرزشی نباید وجود داشته باشد.
- برای قراردادن میکروسکوپ، محل میز مخصوصی باید پیش‌بینی شود.
- خوردن اغذیه و نوشابه در آزمایشگاه مجاز نبوده و محل دیگری باید در نظر گرفته شود.

-۲ عوامل ایمنی در طراحی

برای آزمایشگاه معمولاً ساختمان یک طبقه در نظر گرفته می‌شود. موضوع ایجاد تهویه، هود آزمایشگاهی، گازرسانی، آب‌رسانی، انبار مواد شیمیایی، نگهداری نمونه‌های آب، نگهداری محلولها و داروها، کلاً ایجاب می‌نماید که ساختمان آزمایشگاه یک طبقه بوده و به آسانی دسترسی به کلیه موارد ذکر شده در بالا فراهم گردد.

مصالح ساختمانی باید از مواد غیرقابل اشتعال و نسوز انتخاب شده، همچنین میزکار، کف پوشها و سایر عوامل، در مقابل اسید و قلیا مقاوم باشد.

تهویه هوای آزمایشگاه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هوا مرتبًا باید در جریان باشد.

هود^۱ یا دودکش تهویه برای تخلیه مواد سمی، واکنشهای قابل انفجار در مکان مناسب تعییه شود و سرعت هوا در قسمت ورودی هود، زمانی که درهای آزمایشگاه و پنجره‌ها باز است، حداقل ۲۵ سانتیمتر بر ثانیه تنظیم گردد.

میز آزمایشگاه پشت به پشت و یا پشت به دیوار قرار خواهد گرفت. ارتفاع میزکار بستگی به دستگاه مورد استفاده دارد. مثلاً اگر از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی^۲ استفاده می‌شود، کار به حالت نشسته است، ارتفاع میز ۷۵ سانتیمتر خواهد بود. ارتفاع میزکار برای انجام دادن آزمایشهای شیمیایی ۹۰ سانتیمتر است.

شرایط ایمنی بهداشت کار، دفع دود، آلودگی هوا، لوازم آتش‌نشانی، تجهیزات مربوط به اعلان خطر، دوش آب‌گرم و سایر موارد ایمنی باید در نظر گرفته شود. کابلهای برق باید دارای پوشش مقاوم بوده و مقررات ایمنی خدمات برق‌رسانی کاملاً مراعات گردد.

دستگاههای تولید هوای فشرده (کمپرسور^۳، تهویه، گاز، بخار، گرمایشی، گاز نیتروژن وغیره در خارج از محیط کار آزمایش قرار داده می‌شود. دفع پسابها، باید از طریق لوله‌های فاضلاب با شیب تند انجام گیرد، و ضایعات مربوط به آزمایشهای باکتریولوژی و بیولوژی از طریق لوله‌های فاضلاب به لوله اصلی فاضلاب خروجی هدایت گردد.

-۳ آزمایشگاه سیار

در عملیات صحرایی هیدروژئوشیمیایی، اندازه‌گیری پارامترهای درجه حرارت، pH، هدایت الکتریکی و تعیین میزان یون کلراید در محل ظهور آب انجام می‌شود. این گونه آزمایشهای به انگلیسی تجزیه بخشی^۴ گفته می‌شود. در

1- Hoods

2- Atomic Absorption Spectrophotometer

3- Compressor

4- Partial Analyses

بررسیهای کیفی آب، پارامترهای T.D.S، هدایت الکتریکی، pH، کربنات و بیکربنات، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم مدنظر بوده و اندازه‌گیریهای آنها در عملیات وارد می‌گردد. چنانچه پارامترهای دیگری از جمله نیترات، فلوراید و آهن و غیره مورد نظر باشد، تجزیه کامل^۱ نامیده می‌شود.

در پروژه‌های مطالعات آبهای زیرزمینی، آزمایش‌های تجزیه بخشی در محل و تجزیه کامل در آزمایشگاه مرکزی انجام می‌گیرد. در پروژه‌های بررسی آبهای سطحی برای تعیین مواد معلق رسوبی از کاغذهای صافی μm که در آزمایشگاه مرکزی شماره‌گذاری، توزین و در ظروف پیرکس با در سمباده‌ای قرار داده شده، استفاده می‌گردد. این ظروف به محل ایستگاههای هیدرومتری ارسال می‌گردد. کاغذ صافی حاوی مواد معلق رسوبی صاف شده و حجم آب نمونه به انضمام نمونه‌های تجزیه کامل به آزمایشگاه مرکزی برای توزین مجدد و محاسبات نهایی برگشت داده می‌شود.

در پروژه‌های ویژه هیدروژئوژئمیایی، پروژه‌های نیمه تفصیلی آبهای زیرزمینی، آبخیزداری، آبیاری، زهکشی و سایر پروژه‌های طولانی مدت از نظر سرعت و دقت و ملاحظات اقتصادی آن و با تهیه حداقل دستگاههای زیر و استقرار و جایگذاری این وسایل در محل پروژه مورد نظر، یک واحد آزمایشگاه تأسیس و با تعلیم یک یا دو نفر از کمک کارشناسان هیدروژئوژئمی، پس از عملیات صحراوی، اقدام به اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر می‌گردد.

- ترازوی آنالیتیکی با دقت $1/0$ میلی‌گرم
- کوره الکتریکی 1000 درجه سانتیگراد
- دستگاه آب مقطرگیری
- دستگاه گر مخانه 25° درجه سانتیگراد مجهز به ترمومتر و کرونومتر
- حمام آبی یا بن‌ماری
- اجاق الکتریکی 25° درجه سانتیگراد با ترمومتر
- دستگاه pH متر
- دستگاه کنداکتیویمتر
- دستگاه اندازه‌گیری چند منظوره 4 دستی (دما، EC) (pH,
- دستگاه نورسنج شعله‌ای 5
- دستگاه فام سنج 6
- کاغذ صافی 45° میکرومیلی‌متر به قطر 15 سانتی‌متر
- کاغذ صافی بدون خاکستر
- پایه قیف

1- Full Analyses

2- Oven

3- Hot Plate

4- Multimeter

5- Flame photometer

6- Spectro photometer

- قیف پلی اتیلنی

- وسایل شیشه‌ای پیرکس و چینی


- دسیکاتور شیردار پیرکس یا آلومینیومی

- مواد و معرفه‌ای شیمیایی استاندارد

برای انجام دادن آزمایش‌های فوری صحرایی می‌توان از دستگاه‌های قابل حمل استفاده نمود.

در آزمایش‌گاه‌های مستقر و یا صحرایی روش‌های حجم‌سنجدی با سولفوریک اسید برای اندازه‌گیری کربنات و بی‌کربنات و حجم‌سنجدی با نیترات نقره برای اندازه‌گیری کلراید انتخاب شده است. در مورد آنیون سولفات نظر به این‌که غلظت سولفات در دامنه وسیعی باید اندازه‌گیری شود، روش وزن‌سنجدی^۱ یا وزنی انتخاب شده که به خوبی جوابگو می‌باشد، زیرا سایر روش‌های پیشنهادی پیوسته در دامنه خاصی از دقت قرار داشته و پایین‌تر یا بالاتر از آن حد نتیجه صحیحی را به دست نمی‌دهد. برای اندازه‌گیری کاتیونهای کلسیم و منیزیم از روش کمپلکسومتری با کمپلکس «سدیم اتیلین دی آمین تراستات» برای تعیین سختی آب و از روش نورسنج شعله‌ای برای اندازه‌گیریهای سدیم، پتابسیم استفاده می‌شود.

در شکل ۲ طرح یک آزمایشگاه کوچک سیار به طول ۵ متر و عرض ۲/۵ متر نشان داده شده است. آزمایشگاه مجهز به یخچال، پمپ خلاء، اتوکلاو، لامپ فلورسنت، آب گرم‌کن، هواکش تهویه، سیستم گرمایشی، سیلندرگاز، گرمانه و دستگاه آب مقطرگیری است. در این طرح یک مخزن ذخیره آب بر روی سقف و همچنین منبع دفع فاضلاب در زیر شاسی آزمایشگاه سیار پیش‌بینی شده است.

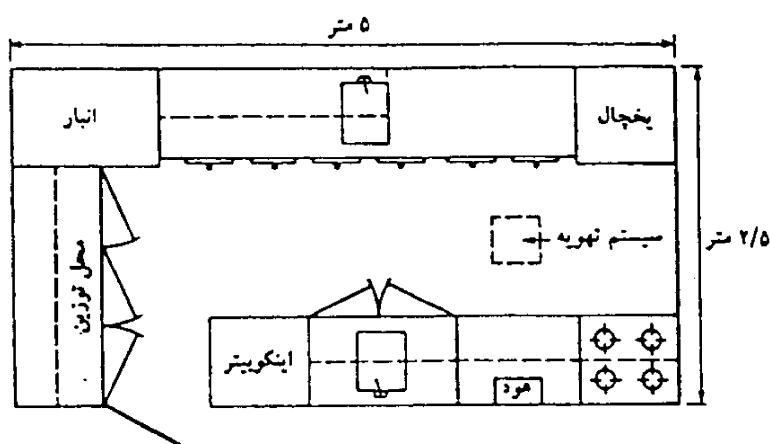

شکل ۲ - آزمایشگاه سیار

۴- انتخاب دستگاههای آزمایشگاهی

برای انتخاب دستگاههای اندازه‌گیری، عوامل مختلفی، نظیر برنامه کار، سرعت و دقت آزمایش، تعداد آزمایشها و همچنین هدف نهایی از انجام آزمایشها، دخالت دارند. مسئول پروژه نسبت به شناسایی روش کار و نوع آزمایش و میزان اعتبار مالی که برای مطالعه و بررسی پارامترهای هیدروژئو شیمیایی اختصاص داده شده، تصمیم‌گیری می‌نماید. لوازم و دستگاههای مورد نیاز براساس آنچه که در قسمتهای مختلف تشکیل آزمایشگاه آمده، انتخاب خواهد گردید. به علاوه از دستگاههای اسپکترو کالریمتری^۱ و اسپکترو فتو مترا جذب اتمی^۲ نیز می‌توان استفاده نمود.

- روش اسپکترو کالریمتری: در این روش آزمایش با اندازه‌گیری شدت جذب نور در دستگاه اسپکترو فتو مترا انجام می‌گیرد. لازم است که ابتدا دستگاه با غلظتها معین از عناصر موردنظر، واسنجی شده^۳ و سپس نسبت به آزمایش اقدام شود.

- روش اسپکترو فتو مترا جذب اتمی: امروزه در اغلب آزمایشگاهها این روش متداول گردیده و به آسانی پارامترها، در غلظتها مختلف با دقت بسیار بالا اندازه‌گیری می‌شوند.

- سایر روشهای اندازه‌گیری فلزات: روشهایی مانند پولا روگرافی، کروماتوگرافی، اسپکتروگرافی و غیره نیز وجود دارد که استفاده از آنها بستگی به حجم نمونه‌ها و تعداد آزمایشها و امکانات سازمانی دارد.

- کیتهای آزمایشگاهی: در آزمایشگاههای صحرایی، معمولاً از کیتهای مختلف که به وسیله شرکتهای شیمیایی، طراحی و ارائه گردیده، استفاده می‌شود. کیتها برای یک یا چندین آزمایش مختلف تهیه شده و ممکن است تا ۲۰ نوع آزمایش با استفاده از آنها، انجام گیرد. یک کیت کامل، مجهز به دستگاه رنگ‌سنجدی و حجم‌سنجدی خواهد بود که شامل نورسنج pH متر و هدایت‌سنج سیار می‌باشد.

معایب آنها، عدم دقت کافی نسبت به روشهای آنالیز آزمایشگاهی است که از آنها برای آزمایشها معمول کیفی منابع آب استفاده می‌شود.

۵- انتخاب مواد شیمیایی

مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه باید کاملاً خالص^۴ (خالص آزمایشگاهی P.A) بوده و ناخالصیهای موجود بر روی شیشه آن ذکر شده باشد. معمولاً در صد خلوص مواد شیمیایی و فرمول مولکولی آنها نیز ثبت می‌شود. باید توجه نمود که تاریخ و مهلت استفاده از مواد شیمیایی منقضی نشده باشد. مواد شیمیایی سمی نظیر سدیم و پتاسیم سیانید با علامت مشخصی، در قفسه جداگانه قرار داده شود، برای اطلاع و آگاهی از خطرات مواد شیمیایی پودر و یا مایع، از عنایین، "سمی"، "خطرناک"، "احتیاط"، "قابل اشتعال" بر روی برچسب ظروف محتوى مواد شیمیایی نوشته شود.

1- Colorimetric Spectrophotometer

2- Atomic Absorption Spectrophotometer

3- Calibrated

4- Pure Analysis

۶- ظروف آزمایشگاهی

در سالهای اخیر انواع ظروف آزمایشگاهی عرضه شده، که بر حسب ضرورت و امکانات مالی و نیروی انسانی موجود در محل، می‌توان انتخاب و مورد استفاده قرار داد.

ظروف شیشه‌ای مورد استفاده معمولاً از جنس پیرکس بوده و در مقابل مواد شیمیایی و حرارت مقاوم می‌باشد. بورتها بیکار از طریق حجم‌سنگی برای اندازه‌گیری محلولهای قلیایی به کار برده می‌شوند از جنس پیرکس است. از ظروف چینی، آهن، نیکل، پلاتین و فولاد زنگنزن و سایر ظروف نیز بر حسب ضرورت و توصیه کارخانجات سازنده، می‌توان استفاده نمود. ظروف شیشه‌ای معمولاً با محلولهای اسیدی شستشو داده می‌شوند و از مخلوط تمیزکننده سولفوکرومیک اسید (۳۵ میلی لیتر محلول اشباع پتاسیم بیکرومات در یک لیتر سولفوریک اسید غلیظ) و یا از محلول پرمگنات قلیایی و یا اکسالیک اسید استفاده می‌شود.

لوازم شیشه‌ای آزمایشگاهی شامل بطریهای نمونه‌برداری، لوله‌های آزمایش، انواع پی‌پت، بورت، بشر، ارلن‌مایر، بالن ژوژه، مزور و سایر لوازم است.

۷- نمونه‌برداری

صحت نتایج آزمایش و تعیین کیفیت واقعی آب بستگی به نمونه‌برداری اصولی از آب دارد. ترکیب شیمیایی نمونه باید معرف حقیقی از ترکیب ماده‌ای باشد که این نمونه از آن برداشته شده، و از هر جهت باید نماینده منبع آب باشد. در این صورت آزمایش‌کننده مطمئن خواهد بود که بر روی نمونه واقعی آب کار نموده و گزارش درست آب را ارائه می‌نماید. شرایط محلی، درجه حرارت، عمق آب در نمونه‌برداری مؤثر بوده و هنگام نمونه‌برداری باید گزارش شود. چگونگی نمونه‌برداری از منابع آب جهت اندازه‌گیری پارامترهای مختلف هیدروژئوشیمیایی، جنس و حجم بطری به کار برده شده و زمان آزمایش دقیقاً در استاندارد شماره ۸۰-الف طرح استاندارد مهندسی آب کشور ارائه شده، که باید مدنظر قرار گیرد. ضمناً، به پاره‌ای از نکات عمومی مهم در تجزیه کامل^۱ اشاره می‌شود.

در نمونه‌برداری از منابع آبی باید تمهیداتی به عمل آید تا نمونه برداشته شده دارای کیفیتی بسیار نزدیک به منبع اصلی آب باشد، از این‌رو در چاههای عمیق باید پس از ده دقیقه پمپاژ با دقت و بدوز این‌که هوا وارد بطری شود، نمونه‌برداری انجام گیرد و از تلاطم آب جلوگیری شود، در آبهای سطحی باید از مقطع معین رودخانه، چهار نقطه انتخاب و از عمق معین نمونه‌برداری به عمل آید. حجم نمونه مورد نیاز بین ۱ تا ۳ لیتر است.

نمونه برداری برای آزمایش باکتریولوژی تحت شرایط خاص و با ظرف مخصوص که از طرف آزمایشگاه فرستاده خواهد شد، به عمل می آید، شرایط استریل نیز باید در نظر گرفته شود. فاصله بین نمونه برداری تا انجام آزمایش باید در حداقل زمان بوده و به هنگام نقل و انتقال نمونه ها باید دقت لازم به عمل آید. برخی از پارامترهای مورد اندازه گیری در تجزیه کامل شامل، دما، pH، هدایت الکتریکی، کربنات، بیکربنات و کاتیونهای کلسیم و منیزیم باید به فوریت صورت گیرد. دمای آب معمولاً در محل نمونه برداری تعیین می گردد.

واضح است که انتخاب نمونه با حجم اندک برای تجزیه و اظهار نظر قطعی، نمی تواند یک مرحله ای باشد، بلکه نمونه برداری در زمانهای مختلف و استمرار آزمایشها، باید با توجه به تغییرات درجه حرارت، جریان آب، درجه آبودگی و سایر شرایط، به طور مدام به عمل آمده و در نهایت ممکن است از میانگین آماری نتایج برای ارائه گزارش نهایی، استفاده گردد.

-۸ برنامه آزمایش

اولین مرحله برنامه ریزی برای مطالعه کیفیت آب، تصمیم گیری در مورد انتخاب پارامترهای مختلف فیزیکی و شیمیایی آب است. نوع و تعداد آنها برای آزمایش در آزمایشگاه باید تعیین گردد. آزمایشها هدایت الکتریکی، pH، قلیاییت، سختی کل، رنگ، فلزات کمیاب، ممکن است در محل انجام شود. ولی سایر پارامترها، نظیر یونها، مواد آلی و غیره در آزمایشگاه اندازه گیری می شوند.

امروزه با توسعه روشهای تجزیه آزمایشگاهی و ابداع دستگاههای اندازه گیری خودکار، پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه سرعت عملیات آزمایشگاهی و انجام آزمایشها در زمانهای کوتاه، حاصل گردیده به طوری که در یک آزمایشگاه آب قبل از اختراع دستگاه خودکار تعداد آزمایش یک پارامتر در سال ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ بوده و سپس با استفاده از دستگاههای خودکار پیشرفت به ۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ رسیده است و این پیشرفت در اثر مهارت و تجربه کارکنان آزمایشگاه و نوع دستگاه حاصل شده و زمان آزمایش را کاهش داده است.

-۹ تهیه لوازم

انتخاب پارامترهای مورد آزمایش بستگی به هدف برنامه مطالعاتی کیفیت آب، امکانات، تجهیزات، تسهیلات و اعتبارات دارد. تهیه دستگاهها و لوازم آزمایش نیز بستگی به روش کار و شیوه های انتخابی برای انجام تجزیه های مختلف دارد. به طور معمول در هر آزمایشگاه تجزیه آب، به یک سری دستگاههای اولیه نظیر ترازو، آب مقطر گیری،

گرمانه، حمام آبی^۱، کوره، اجاق الکتریکی^۲، ظروف شیشه‌ای، انواع پسیپت، بورت، همچنین بوته آزمایش، ینچال، اتوکلاو، محفظه کشت^۳، تبخیرکننده سریع^۴، گریز از مرکز، بهمزن و سایر دستگاههای کوچک و بزرگ بر حسب ضرورت کار، مورد نیاز است. در مرحله بعدی تعیین پارامترهای مورد اندازه‌گیری مطرح می‌شود و سپس نسبت به دستگاههای تجزیه و داروهای مورد نیاز اقدام می‌شود.

۱۰ - آزمایش آب

با دریافت نمونه آب، نخست پارامترهای فیزیکی نظیر رنگ، کدورت، pH، هدایت الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود و سپس نسبت به تعیین یونها که شامل کاتیونها و آنیونهای محلول در آب است، اقدام می‌گردد. دقت اندازه‌گیریها را می‌توان از مقایسه جمع کاتیونها با آنیونها بر حسب میلی‌اکی والان بر لیتر بررسی نمود. درصد خطای را می‌توان با استفاده از رابطه زیر به دست آورد.

$$\frac{\text{جمع آنیونها} - \text{جمع کاتیونها}}{\text{کل یونها}} \times 100 = \text{درصد خطای}$$

نتایج اندازه‌گیری شده بر حسب میلی‌اکی والان بر لیتر گزارش می‌شود و برای تبدیل آن به میلی‌گرم بر لیتر می‌توان آنها را در وزن اکی والان هر یون ضرب نمود. عناصر کمیاب معمولاً بر حسب میلی‌گرم بر لیتر یا میکروگرم بر لیتر گزارش می‌شوند.

معمولًاً جمع آنیونها برابر با جمع کاتیونهاست. چنانچه نتایج آزمایشها اختلاف یک درصد را نشان دهد، نتیجه بسیار عالی است، اگر اختلاف بیشتر بود، باید نسبت به تکرار آزمایشها و وارسی معرفها، اقدام گردد. در آبهای خیلی سبک که مواد آلی دارند، درصد خطای بالایی در آزمایشها مشاهده می‌شود. این خطای براساس خصوصیات کیفی آب موجود در طبیعت بوده و ارتباطی به خطای اندازه‌گیری ندارد و یا ممکن است یونهای دیگری در آب باشد. معمولاً یونهای کاتیونی عمدۀ کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و یونهای آنیونی عمدۀ کربنات، بیکربنات، سولفات و کلراید می‌باشند. یون آهن محلول دو ظرفیتی مربوط به کاتیونها و نیترات مربوط به آنیونها می‌گردد. سیلیس به لحاظ شکل کلوئیدی، جداگانه گزارش می‌شود.

1- Water bath

2- hot plates

3- Incubator

4- Flash evaporator

در مرحله بعد، عناصر کمیاب مورد آزمایش قرار می‌گیرند (جدول ۳) که تعیین آنها بستگی به ماهیت و هدف هر پروژه دارد. جدول ۱ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب را با توجه به روش‌های آزمایش و انتخاب دستگاههای اندازه‌گیری نشان می‌دهد.

جدول ۱- راهنمای روش اندازه‌گیری پارامترهای هیدروشیمیایی آب

پارامترها	روش آزمایش	دستگاههای اندازه‌گیری	
هدایت الکتریکی	دستگاهی مقایسه‌ای	هدایت سنج (کنداکتیویمتر) مقایسه با محلولهای استاندارد و یا مقایسه‌گر	رنگ
کدورت	مقایسه‌ای	کدورت سنج	
pH	دستگاهی	دستگاه pH سنج و یا مقایسه‌گر با دیسک مخصوص	
کلسیم منیزیم	حجم سنجی اختلاف سختی کل با کلسیم	ظروف شیشه‌ای حجم سنجی بورت، پی‌پت، ارلن مایر	بیرونی کاترانهای بیرونی
سدیم پتاسیم	حجم سنجی نورسنج شعله (فلیم فتوتمتری)	نورسنج شعله (فلیم فتوتمتری)	بیرونی بیرونی
کربنات بی‌کربنات متیل اورانز	حجم سنجی حجم سنجی	ظروف شیشه‌ای حجم سنجی بورت، پی‌پت، ارلن مایر ظروف شیشه‌ای حجم سنجی بورت، پی‌پت، ارلن مایر	بیرونی بیرونی
سولفات کلراید	حجم سنجی - وزنی	مبدل یونی و یا حجم سنجی ظروف شیشه‌ای حجم سنجی بورت، پی‌پت، ارلن مایر	بیرونی بیرونی
نیترات سیلیس	رنگ سنجی با تعیین جذب نور	فام سنج (اسپکتروفتومتر) فام سنج (اسپکتروفتومتر)	بیرونی بیرونی

جدول ۲ مربوط به پارامترهای مواد آلی و مغذی^۱ است. اندازه‌گیری این پارامترها نیز ضروری بوده و میزان بار آводگی غذایی که از طریق صنایع و منابع غذایی و سایر منابع وارد آب زیرزمینی می‌شود، را نشان می‌دهد.

جدول ۲- پارامترهای مواد آلی و مغذی

دستگاههای اندازه‌گیری	روش آزمایش	پارامترها
ظرف حجمی شیشه‌ای، اسپکتروفوتومتر ظرف حجمی شیشه‌ای، اسپکتروفوتومتر در روش کجلدال نیاز به دستگاه تثبیت، منع گرمایش و سیستم تهویه اسید می‌باشد، ظروف شیشه‌ای حجم‌سنجی، بورت و اسپکتروفوتومتر است اسپکتروفوتومتر	تشکیل رنگ و اندازه‌گیری جذب نور تشکیل رنگ و اندازه‌گیری جذب نور ثبت و حجم‌سنجی تشکیل رنگ و اندازه‌گیری جذب نور	مواد مغذی : انواع فسفات نیتروژن معدنی مانند نیترات، نیتریت و غیره کل نیتروژن که از طریق کجلدال به دست می‌آید. سیلیس ^۱
طریهای نمونه‌برداری، ظروف شیشه‌ای حجم‌سنجی، بورت، پی‌پت، ارلن‌مایر معمولًاً با دستگاه در محل نمونه‌برداری اندازه‌گیری می‌شود.	ثبت و حجم‌سنجی	آلی : اکسیژن محلول DO
دستگاه کشت بررقی، ظروف شیشه‌ای دستگاه اندازه‌گیری کل کربن آلی ^۲ کندانسور بازکشت، ظروف شیشه‌ای حجم‌سنجی، بورت، پی‌پت، ارلن‌مایر ظروف شیشه‌ای حجم‌سنجی و فام‌ستج	کشت و حجم‌سنجی ^۳ سوزاندن و تجزیه بالشعه مادون قرمز ^۴ سولفوکرومیک - حجم‌سنجی برای کاهش اکسیژن تقطیر - تشکیل رنگ و اندازه‌گیری جذب نور	اکسیژن‌خواهی بیوشیمیایی BOD کل کربن آلی TOC اکسیژن‌خواهی شیمیایی COD فلن

۱۱- عناصر نادر^۴

برای اندازه‌گیری عناصر کمیاب و فلزات نادر آب که ممکن است از منابع معدنی و یا صنایع مختلف به‌طریقی، به سفره آب زیرزمینی وارد شده باشند، با توجه به وضعیت مالی و اعتبارات طرح می‌توان به دو روش زیر عمل نمود.
- روش رنگ‌سنجی^۵: در این روش جذب کمپلکس رنگ به‌وسیله فام‌ستجی اندازه‌گیری می‌شود. دستگاه قبلًاً

1- Silica

2- Incubation

3- Infrared analyses

4- Rare Earth Elements

5- Colourimetric method

نیز باید با محلولهای دارای غلظت معلوم و استنجی گردد. این روش معمولاً زمان زیادی را در بر می‌گیرد و حساسیت لازم نسبت به تعیین مقدار دقیق فلز موردنظر دارد.

- روش فامستنجی جذب اتمی^۱ : به لحاظ سادگی و سهولت در کار این روش متداول بوده و برای اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی به ویژه فلزات کمیاب از دقت کافی برخوردار می‌باشد.

- روش‌های دیگری برای اندازه‌گیری فلزات نادر در آب، نظیر تکنیکهای پولاروگرافی^۲، اسپکتروگرافی^۳ وجود دارد، ولیکن در مرحله اول تشکیل آزمایشگاه، برای اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی، بهترین روش استفاده از فامستنجی جذب اتمی است.

جدول ۳ - عناصر نادر آب

پارامترها	روش اندازه‌گیری	دستگاهها و لوازم آزمایش
آهن منگنز مس روی سرب نیکل کادمیم کروم	جذب نوری و تشدید فعالیت اتمی با تهیه کمپلکسهای شیمیایی و تقطیر با حللهای آلی - حلال بر روی شعله پخش می‌شود و سپس با روش جذب اتمی مقدار فلز اندازه‌گیری می‌گردد.	اسپکتروفتومتری جذب اتمی
	تشکیل ترکیب رنگی و اندازه‌گیری جذب نور	ظرف شیشه‌ای و UV اسپکتروفتومتر
	اسپکتروفتومتری جذب اتمی بدون شعله	اسپکتروفتومتری جذب اتمی

1- Atomic Absorption Spectrophotometric method

2- Polarographic

3- Spectrographic

فرم شماره ۱- ارائه داده های آزمایشگاهی آب

<input type="checkbox"/> ۱۰۰ - ۲۵۰ <input type="checkbox"/> ۲۵۰ - ۷۵۰ <input type="checkbox"/> ۷۵۰ - ۲۲۵۰ <input type="checkbox"/> ۲۲۵۰ - ۵۰۰۰ <input type="checkbox"/> > ۵۰۰۰	<input type="checkbox"/> هدایت <input type="checkbox"/> رودخانه لکتریکی <input type="checkbox"/> S/cm	<input type="checkbox"/> شماره آزمایشگاهی شماره صحرایی گزارش نتایج بدست آمده از آزمایش آب چاه عمیق <input type="checkbox"/> چاه نیمه عمیق <input type="checkbox"/> قنات <input type="checkbox"/> چشمہ <input type="checkbox"/> رودخانه نام مالک یا مالکین مورد استفاده مواد شیمیایی اضافه شده به آب	<input type="checkbox"/> تاریخ نمونه برداری : <input type="checkbox"/> تاریخ آزمایش : <input type="checkbox"/> فاصله زمانی تا آزمایش : <input type="checkbox"/> ویژگیهای فیزیکی :	<input type="checkbox"/> موقعت میبع نمونه برداری آب خام یا تصفیه شده	<input type="checkbox"/> < ۶۰ <input type="checkbox"/> ۶۱ - ۱۲۱ <input type="checkbox"/> ۱۲۱ - ۱۸۰ <input type="checkbox"/> > ۱۸۰																				
<input type="checkbox"/> < ۱۰ <input type="checkbox"/> ۱۰ - ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۸ - ۲۶ <input type="checkbox"/> > ۲۶	<input type="checkbox"/> S.A.R.	<table border="1"><tr><td>میلی اکی والان بر لیتر</td><td>کاتیونها</td><td>میلی اکی والان بر لیتر</td><td>آنیونها</td></tr><tr><td>Ca</td><td>کلسیم</td><td></td><td>CO₃ کربناتها</td></tr><tr><td>Mg</td><td>منزیم</td><td></td><td>HCO₃ بیکربناتها</td></tr><tr><td>Na</td><td>سدیم</td><td></td><td>SO₄ سولفاتها</td></tr><tr><td>K</td><td>پتاسیم</td><td></td><td>Cl کلریدها</td></tr></table>	میلی اکی والان بر لیتر	کاتیونها	میلی اکی والان بر لیتر	آنیونها	Ca	کلسیم		CO ₃ کربناتها	Mg	منزیم		HCO ₃ بیکربناتها	Na	سدیم		SO ₄ سولفاتها	K	پتاسیم		Cl کلریدها	<input type="checkbox"/> اشل دبي	<input type="checkbox"/> درجه حرارت آب هنگام نمونه برداری °C <input type="checkbox"/> درجه حرارت نمونه آب هنگام آزمایش °C <input type="checkbox"/> اکسیژن محلول mg/l D.O <input type="checkbox"/> کربن دی اکساید (CO ₂) mg/l <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> رنگ <input type="checkbox"/> کلرین <input type="checkbox"/> روغن <input type="checkbox"/> قلایایت (فل) mg/l <input type="checkbox"/> mg/l CaCO ₃ <input type="checkbox"/> قلایایت در مقابله فل فتالین mg/l CaCO ₃ <input type="checkbox"/> قلایایت در مقابل میل اورانز mg/l CaCO ₃ <input type="checkbox"/> قلایایت کل mg/l CaCO ₃	<input type="checkbox"/> < ۵۰ <input type="checkbox"/> ۵۱ - ۱۰۰ <input type="checkbox"/> ۱۰۱ - ۲۵۰ <input type="checkbox"/> > ۲۵۰
میلی اکی والان بر لیتر	کاتیونها	میلی اکی والان بر لیتر	آنیونها																						
Ca	کلسیم		CO ₃ کربناتها																						
Mg	منزیم		HCO ₃ بیکربناتها																						
Na	سدیم		SO ₄ سولفاتها																						
K	پتاسیم		Cl کلریدها																						
<input type="checkbox"/> < ۲۰ <input type="checkbox"/> ۲۰ - ۴۰ <input type="checkbox"/> ۴۰ - ۵۰ <input type="checkbox"/> ۶۰ - ۸۰ <input type="checkbox"/> > ۸۰	<input type="checkbox"/> درصد سدیم Na%	<table border="1"><tr><td>Fe</td><td>آهن</td><td>F</td><td>فلورایدها</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>NO₃ نیتراتها</td></tr></table> جمع درصد خطأ : سیلیس SiO ₂ به حالت محلول / mg/l سیلیس SiO ₂ به حالت کلوئیدی / mg/l	Fe	آهن	F	فلورایدها				NO ₃ نیتراتها	<input type="checkbox"/> جمع mg/l mg/l مواد معلق رسوبی (550. [°] C) mg/l مواد آبی فرار (T.H.) mg/l سختی کل (T.H.) c/cm هدایت الکتریکی mg/l CaCO ₃ سختی غیر کربناتی mg/l H ₂ S mg/l L.A.S - A.B.S درجه هایها mg/l Ca کلسیم mg/l Mg منزیم mg/l Fe آهن mg/l Al آلومینیم mg/l As آرسنیک mg/l Mn منگنز mg/l Na سدیم mg/l K پتاسیم mg/l سولفاتها mg/l Cl کلرایدها mg/l F فلورایدها mg/l PO ₄ فسفات mg/l B بر	<input type="checkbox"/> < ۲۵ <input type="checkbox"/> ۲۶ - ۲۵۰ <input type="checkbox"/> ۲۵۱ - ۶۰۰ <input type="checkbox"/> > ۶۰۰													
Fe	آهن	F	فلورایدها																						
			NO ₃ نیتراتها																						
<input type="checkbox"/> < ۰/۵ <input type="checkbox"/> ۰/۵ - ۱ <input type="checkbox"/> > ۱	<input type="checkbox"/> B	<table border="1"><tr><td>ملاحظات</td><td>mg/l NH₃ آمونیاک</td></tr><tr><td></td><td>mg/l NO₂ نیتریت</td></tr><tr><td></td><td>mg/l NO₃ نیترات</td></tr><tr><td></td><td>mg/l نیتروژن آلی</td></tr></table> Heavy Metals : فلزات سنگین : Cr کرم Zn روی Pb سرب Cu مس Cd کادمیم	ملاحظات	mg/l NH ₃ آمونیاک		mg/l NO ₂ نیتریت		mg/l NO ₃ نیترات		mg/l نیتروژن آلی	<input type="checkbox"/> T.D.S <input type="checkbox"/> Cl <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> PO ₄ <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> < ۰/۵ <input type="checkbox"/> ۰/۵ - ۱/۰ <input type="checkbox"/> > ۱ <input type="checkbox"/> < ۲۰۰ <input type="checkbox"/> ۲۰۰ - ۱۰۰۰ <input type="checkbox"/> > ۱۰۰۰													
ملاحظات	mg/l NH ₃ آمونیاک																								
	mg/l NO ₂ نیتریت																								
	mg/l NO ₃ نیترات																								
	mg/l نیتروژن آلی																								
<input type="checkbox"/> قابل شرب <input type="checkbox"/> دارای محدودیت = <input type="checkbox"/> غیر قابل شرب	<input type="checkbox"/> قابل کشت	<table border="1"><tr><td>آزمایش کنندگان</td></tr><tr><td>مهندسان</td></tr><tr><td>وارسی نهایی</td></tr></table>	آزمایش کنندگان	مهندسان	وارسی نهایی	<input type="checkbox"/> پروژه / شرکت گزارش به	<input type="checkbox"/> H ₂ S فلزات سنگین																		
آزمایش کنندگان																									
مهندسان																									
وارسی نهایی																									
<input type="checkbox"/> دارای محدودیت کشت				<input type="checkbox"/> نظرات کلی :																					

فهرست منابع و مأخذ

- ۱ علوی، علی اکبر؛ ۱۳۴۹ "آنالیز عملی آبهای آشامیدنی - زراعی و صنعتی" انتشارات سازمان آب منطقه‌ای
تهران

2- "WATER QUALITY SURVEYS" (1988) UNESCO - WHO

3- "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE
WATER" 1992

4- FETTER, C.W., 1993 " CONTAMINANT HYDROGEOLOGY " MACMILLAN
PUBLISHING COMPANY NEW YORK U.S.A.

5- FETTER, C.W., 1993 "APPLIED HYDROGEOLOGY" MACMILLAN
PUBLISHING COMPANY NEW YORK U.S.A.

In the Name of God
Islamic Republic of Iran
Ministry of Energy
Iran Water Resources Management CO.
Deputy of Research
Office of Standard and Technical Criteria

Instructions for Water Laboratory Set Up

Publication No. 265

این نشریه

با عنوان "برپایی آزمایشگاه آب" شامل تعیین محل برای
برپایی و تاسیس یک واحد آزمایشگاه آب از نظر شیمیایی،
فیزیکی، بیولوژی، باکتریولوژی، آلودگی آب، طراحی
مهندسی، ساختمانی، تاسیساتی، نورآرایی و ترتیب چیدن
وسایل آزمایشگاهی می باشد. در مقدمه به طور خلاصه
به اهمیت برپایی آزمایشگاه های آب ثابت و سیار طبق
ضوابط محاسباتی پیشرفته برای حفاظت و ایمنی و
دستگاه های مورد بطره برداری اشاره شده است. در
متن استاندارد نیز، طراحی لازم برای تاسیس آزمایشگاه
آب با توجه به عوامل محلی و تاسیسات ساختمانی و
دستگاه های مورد نیاز و... بیان گردیده است. در انتهای
یک فرم برای ثبت داده های آزمایش ارائه شده و نیز
منابع و مأخذ ذکر شده است.

معاونت امور پشتیبانی
مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-425-2



9 789644 254253